

# COVID-19 Antigen Speichelabstrich Schnelltest Kit (Colloidal Gold)




- ➔ **Sicherheit**  
durch höchste Qualitätsstandards
- ➔ **Genauigkeit**  
durch führende technologische Stärke
- ➔ **Vertrauen**  
durch langjährige Erfahrung

Erhältlich in den Packungsgrößen: 1 Testkit, 5 Testkits und 25 Testkits.

## Wirkungsweise

Das COVID-19 Antigen Speichelabstrich Schnelltest Kit weist anhand immunochromatographischer Technologie das neuartige Coronavirus im menschlichen Speichel nach. Bei positivem Nachweis von SARS-CoV-2 Antigenen im Speichel erscheint eine farbige Testlinie (T) im Ergebnisfenster. Im Falle eines negativen Ergebnisses erscheint keine Testlinie (T).

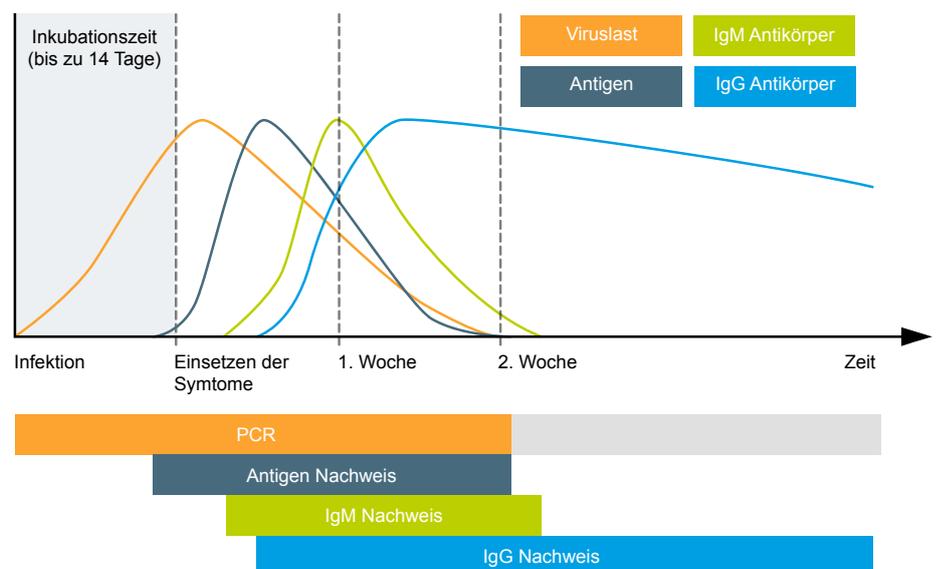


HAFTUNGAUSSCHLUSS: Die Grafik dient nur zu Informationszwecken. Die Nachweisfenster können von Person zu Person variieren.


## Anwendung



**1.** Befüllen des Extraktionsröhrchens mit der Extraktionslösung.

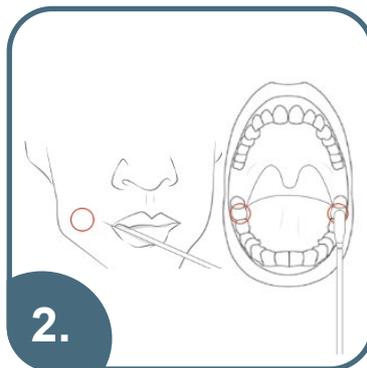


**2.** Entnahme des **Speichelabstrichs** mit Tupfer.

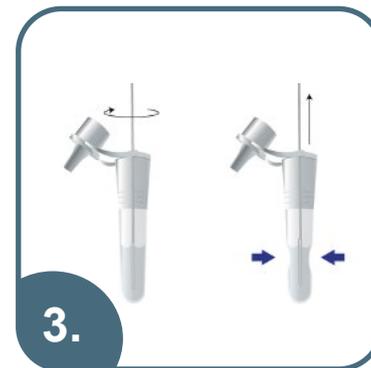

**3.** **Eintauchen des Speichelabstrichs** in Extraktionslösung. Mindestens 5 mal rühren und eine Minute in der Lösung lassen. Bei Entnahme des Tupfers das Röhrchen zusammenpressen und Flüssigkeit aus dem Tupfer drücken.



**4.** **Schließen der Kappe** des Extraktionsröhrchens.

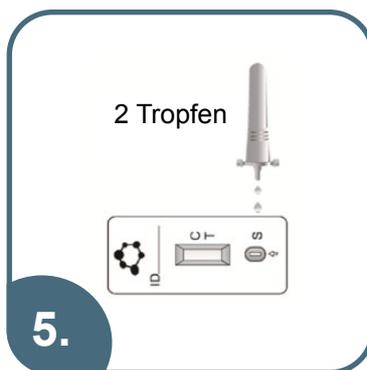


**5.** **Eingabe** von 2 Tropfen der Probe in Probenvertiefung der **Testkarte**.




**6.** Ablesen des **Testergebnisses** nach 15 – 20 Minuten.

## Auswertung des Ergebnisses


**negativ**



**positiv**



**ungültig**



**Sensitivität:** 96.55% (95% CI, 93.05% ~98.32%)  
**Sensitivität:** Die echte Positivquote  
**Spezifität:** >99.00% (95% CI, 99.19% ~100.00%)  
**Spezifität:** Die echte Negativquote  
**Genauigkeit:** 98.86% (95% CI, 97.87% ~99.50%)  
**Genauigkeit:** Die tatsächliche Negativ- und Positivquote  
**Nachweisgrenze:**  $5 \times 10^2$  TCID<sub>50</sub>/mL

Produkt	Packungsinhalt	Packungsgrößen	Probenart	Haltbarkeitsdauer
COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)	Speicheltupfer Extraktionsröhrchen Extraktionslösung Testkarte Gebrauchsanleitung	1 Test /Kit 5 Tests / Kit 25 Tests / Kit	Speichel- abstrich	18 Monate